

Navodila za uporabo



CE
0297

PEOPLE HAVE PRIORITY



Kirurgija

Ročnik S-11 L
z lučjo Mini-LED+

Kazalo

| | |
|---|----|
| Simboli | 4 |
| v navodilih za uporabo | 4 |
| na medicinskem pripomočku/na embalaži | 5 |
| 1. Uvod | 6 |
| 2. Varnostni napotki | 9 |
| 3. Opis izdelka | 13 |
| 4. Zagon | 14 |
| Natikanje/snemanje | 14 |
| Vrtljivi instrumenti | 17 |
| Zamenjava vrtljivega instrumenta | 18 |
| Poskusni zagon | 19 |
| 5. Higiena in nega | 20 |
| Splošni napotki..... | 20 |
| Omejitev pri ponovni pripravi | 22 |
| Prva uporaba na mestu uporabe | 23 |

| | |
|---|-----------|
| Ročno čiščenje | 24 |
| Ročna dezinfekcija | 29 |
| Strojno čiščenje in dezinfekcija..... | 30 |
| Sušenje | 32 |
| Pregled, nega in preverjanje | 33 |
| Embalaža | 38 |
| Sterilizacija | 39 |
| Skladiščenje | 41 |
| 6. Servis | 42 |
| 7. Pribor in nadomestni deli W&H | 43 |
| 8. Tehnični podatki | 44 |
| 9. Odstranjevanje | 46 |
| Garancijska izjava | 47 |
| Pooblaščen servisni partnerji W&H..... | 49 |



OPOZORILO!

(če obstaja nevarnost
telesnih poškodb)



POZOR!

(če obstaja nevarnost
poškodovanja stvari)



Splošna pojasnila,
brez nevarnosti za človeka
ali stvari



Ne zavržite med
gospodinjske odpadke

R_x_{only}

Pozor!

V skladu z ameriško zakonodajo se sme v Združenih državah Amerike ta medicinski pripomoček prodati samo zobozdravniku, zdravniku ali drugi osebi z ustrežno medicinsko izobrazbo, ki ima v zvezni državi, v kateri izvaja svojo prakso, ustrežno licenco in bo ta medicinski pripomoček tudi uporabljala ali njeno uporabo odobrila.

Simboli

na medicinskem pripomočku/na embalaži



Oznaka CE
z identifikacijsko številko
priglašenega organa



DataMatrix Code
za informacije o izdelku
vključno z UDI (Unique
Device Identification)



Struktura podatkov v skladu
s Health Industry Bar Code



Številka izdelka



Možnost termične
dezinfekcije



Možnost sterilizacije do
navedene temperature



Serijska številka



Oznaka kakovosti UL
za priznane sestavne dele za Kanado in ZDA



Datum izdelave

1. Uvod

Politika kakovosti je pri W&H oblikovana tako, da je zadovoljstvo strank vselej na prvem mestu. Predstavljen medicinski pripomoček smo razvili, izdelali in preizkusili v skladu z veljavnimi zakonskimi in normativnimi predpisi.

Za vašo varnost in varnost vaših bolnikov

Preden začnete uporabljati izdelek, preberite navodila za uporabo. Ta vam bodo pojasnila rokovanje z medicinskim pripomočkom ter omogočila brezhibno, gospodarno in varno uporabo.



Upoštevajte varnostne napotke.

Namen uporabe

Kirurška obdelava organske trde substance.



Uporaba, ki ni v skladu z namembnostjo, lahko privede do poškodb medicinskega pripomočka ter s tem povzroči tveganje ter nevarnost za bolnika, uporabnika in druge osebe.

Usposobljenost uporabnika

Pri razvoju in konstruiranju medicinskega pripomočka smo izhajali iz ciljne skupine zdravniki.

Izdelava v skladu z direktivo EU



0297

Medicinski pripomoček je v skladu z določili Direktive 93/42/EGS.

Odgovornost proizvajalca

Proizvajalec je odgovoren za učinke na varnost, zanesljivost in delovanje medicinskega pripomočka samo v primeru, da je bila naprava uporabljena v skladu z naslednjimi navodili:

- > Medicinski pripomoček morate uporabljati v skladu s temi navodili za uporabo.
- > Medicinski pripomoček ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih lahko uporabnik popravil sam.
- > Spremembe ali popravila smejo izvajati samo pooblaščenji servisni partnerji W&H (glejte stran 49).

Strokovna uporaba

Medicinski pripomoček je namenjen izključno strokovni uporabi za predvideni namen ob upoštevanju veljavnih predpisov za varstvo pri delu, ukrepov za preprečevanje nesreč in teh navodil za uporabo.

Medicinski pripomoček lahko pripravljajo in vzdržujejo le osebe, ki so seznanjene s področjem zaščite pred infekcijami, samozaščite in zaščite bolnikov.

Ob ugotovljeni nestrokovni uporabi (npr. zaradi pomanjkljive higiene in nege), neupoštevanju navodil ali uporabi neodobrenega pribora ali nadomestnih delov, podjetje W&H ni zavezano k izpolnitvi kakršnih koli garancijskih zahtevkov ali zahtevkov druge vrste.



O kakršnih koli hudih nezgodah, povezanih z medicinskim pripomočkom, je treba obvestiti proizvajalca in pristojne organe!

2. Varnostni napotki



- > Medicinski pripomoček pred uporabo 24 ur hranite pri sobni temperaturi.
- > Uporaba medicinskega pripomočka je dovoljena le skupaj z oskrbovalnimi enotami, ki izpolnjujejo zahteve standardov IEC 60601-1 (EN 60601-1) in IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2).
- > Vedno poskrbite za primerne delovne pogoje in se prepričajte, da je hladilno sredstvo pripravljeno.
- > Vedno imejte pripravljeno zadostno količino ustreznega hladilnega sredstva in poskrbite za primerno odsesavanje.
- > V primeru izpada oskrbe s hladilnim sredstvom nemudoma zaustavite medicinski pripomoček.
- > Pred vsako uporabo se prepričajte, da medicinski pripomoček ni poškodovan in da so vsi deli primerno pritrjeni.
- > Če je medicinski pripomoček poškodovan, ga ne uporabljajte.
- > Medicinski pripomoček natakните samo, ko motor miruje.
- > V nobenem primeru ne pritisnite vpenjalne ročice medicinskega pripomočka med delovanjem. S tem namreč sprostite vrtljivi instrument oziroma povzročite segrevanje medicinskega pripomočka.
- > Pred vsako uporabo izvedite poskusni zagon.
- > Pazite, da na mestu posega ne pride do pregrevanja.



- > S konico ročnika se ne dotikajte mehkega tkiva (nevarnost opeklin)!
- > Preprečite stik med lučjo LED in mehкими tkivi (nevarnost opeklin zaradi segrevanja luči LED).
- > Medicinskega pripomočka ne uporabljajte kot svetlobno sondo.
- > Ne glejte neposredno v luč LED.



Medicinski pripomoček ni primeren za uporabo v območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Tveganje elektromagnetnih polj



Električna, magnetna in elektromagnetna polja lahko vplivajo na delovanje implantiranih sistemov, kot sta srčni spodbujevalnik in vsadni kardioverter oziroma defibrilator.

- > Pred uporabo medicinskega pripomočka pri bolniku in uporabniku preverite, ali imata implantirane sisteme, ter preverite vstavek.
- > Pretehtajte tveganje uporabe.
- > Medicinskega pripomočka ne približujte implantiranim sistemom.
- > Pripravite se za ukrepanje v sili in se takoj odzovite na vsako zdravstveno spremembo.
- > Simptomi, kot so povišan srčni utrip, neenakomeren pulz in vrtoglavica, so lahko znak za težave s srčnim spodbujevalnikom ali vsadnim kardioverterjem oziroma defibrilatorjem.

Higiena in nega pred prvo uporabo




- > Medicinski pripomoček je ob dobavi zavarjen v polietilensko folijo in ni steriliziran.
- > Polietilenske folije in embalaže ni mogoče sterilizirati.



- > Medicinski pripomoček očistite, dezinficirajte in naoljite.
- > Sterilizirajte medicinski pripomoček, čistilnik šob in cev za hladilno sredstvo.

3. Opis izdelka

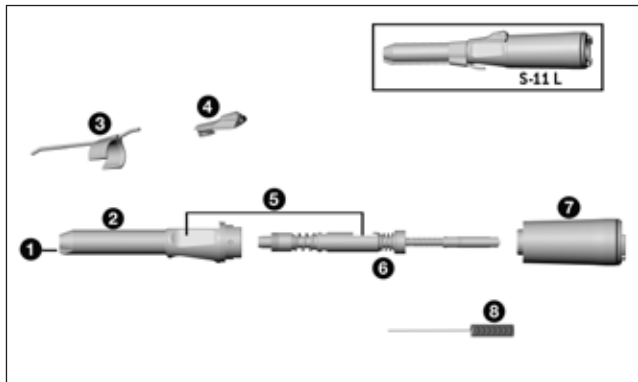

- 1 Luč LED
- 2 Konica ročnika*
- 3 Cev za hladilno sredstvo (nastavljiva)
- 4 Vpenjalna ročica
- 5 Površine vpenjalne ročice
- 6 Gred
- 7 Tulec ročaja*
- 8 Dolgi čistilnik šob

* Simboli na delih 2 in 7

- Odprt tulec ročaja
- ↔ Smer vrtenja
- ▲ Zaklenjen tulec ročaja




Medicinskega pripomočka ne natikajte ali snemajte med delovanjem!



Medicinski pripomoček je primeren za elektromotor EM-19 LC/EM-19 proizvajalca W&H in za W&H Implantmed SI-10xx. Le s to kombinacijo lahko izkoristite vse prednosti medicinskega pripomočka (npr. konstantno osvetlitev pri vsaki hitrosti).




Medicinski pripomoček lahko uporabljate le z elektromotorjem EM-19 LC/EM-19 proizvajalca W&H. Pri uporabi medicinskih pripomočkov z drugimi elektromotorji je odgovornost zgolj pri uporabniku. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

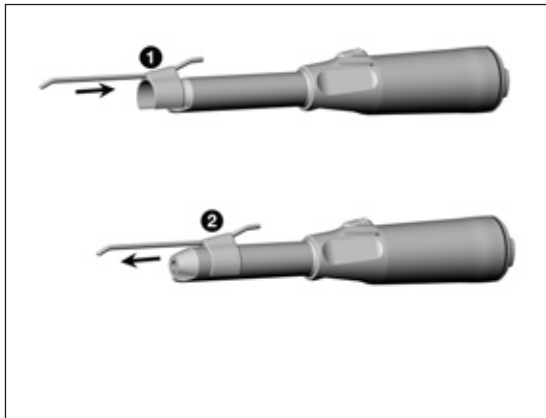

Cev za hladilno sredstvo

- 1 Natakните cev za hladilno sredstvo.
ali
- 2 Snemite cev za hladilno sredstvo.

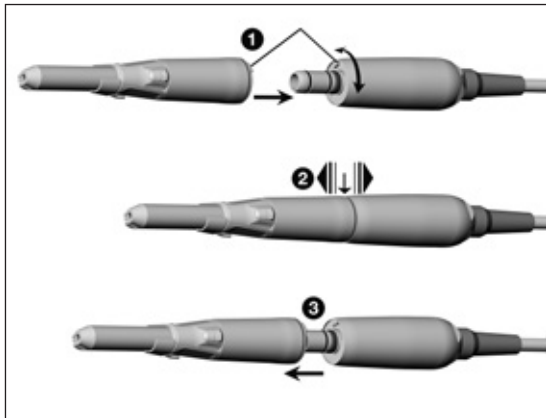

Medicinski pripomoček

❶ Nataknite medicinski pripomoček na motor in ga zavrtite, da se slišno zaskoči.



❷ Preverite primerno pritrjenost.


ali

❸ Snemite medicinski pripomoček z motorja.

Vrtljivi instrumenti



- > Uporabljajte le brezhibne vrtljive instrumente in pazite na smer vrtenja vrtljivega instrumenta. Upoštevajte navodila proizvajalca.
- > Vrtljivi instrument vstavite le, ko medicinski pripomoček miruje.
- > Nikoli ne segajte v še vrteči ali ustavljajoči se vrtljivi instrument.
- > V nobenem primeru ne pritisnite vpenjalne ročice medicinskega pripomočka med delovanjem. S tem namreč sprostite vrtljivi instrument oziroma povzročite segrevanje medicinskega pripomočka.

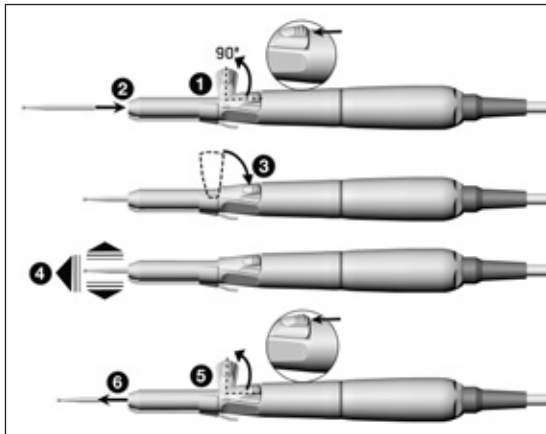

Zamenjava vrtljivega instrumenta

- 1** Sprostite in obrnite vpenjalno ročico.
- 2** Potisnite vrtljivi instrument do omejila.
- 3** Vpenjalno ročico premaknite v izhodiščni položaj.



- 4** Preverite primerno pritrjenost.

ali

- 5** Sprostite in obrnite vpenjalno ročico.
- 6** Odstranite vrtljivi instrument.

Poskusni zagon



Medicinskega pripomočka ne držite v višini oči!

- > Vstavite vrtljivi instrument.
- > Zaženite medicinski pripomoček.



V primeru motenj v delovanju (npr. vibracij, nenavadnih zvokov, segrevanja, izpada hladilnega sredstva oziroma puščanja) **nemudoma zaustavite medicinski pripomoček** in se obrnite na pooblaščenega servisnega partnerja W&H.



> Upoštevajte lokalne in nacionalne zakone, direktive, standarde in predpise za čiščenje, dezinfekcijo in sterilizacijo.



> Nosite zaščitno obleko, zaščitna očala, zaščitno masko in rokavice.



> Za ročno sušenje uporabljajte samo filtriran stisnjen zrak brez vsebnosti olja z obratovalnim tlakom največ 3 bare.

Čistilna in dezinfekcijska sredstva



- > Upoštevajte napotke, navodila in opozorila proizvajalca čistilnih in/ali dezinfekcijskih sredstev.
- > Uporabljajte samo detergente, ki so predvideni za čiščenje in/ali dezinfekcijo medicinskih pripomočkov iz kovine in umetne mase.
- > Obvezno morate upoštevati koncentracije in čase učinkovanja, ki jih je navedel proizvajalec dezinfekcijskega sredstva.
- > Uporabljajte dezinfekcijska sredstva, ki so preizkušena in ocenjena kot učinkovita s strani organizacij Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH = Združenje za uporabno higieno), Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP = Avstrijsko društvo za higieno, mikrobiologijo in preventivno medicino), Food and Drug Administration (FDA = Agencija za hrano in zdravila) in U.S. Environmental Protection Agency (EPA = Ameriška agencija za zaščito okolja).



Če navedena čistilna in dezinfekcijska sredstva niso na voljo, je odgovornost uporabnika, da validira svoje postopke.



Na življenjsko dobo in delovanje medicinskega pripomočka odločilno vplivata mehanska obremenitev pri uporabi in kemični vplivi pri ponovnih pripravah.

- > Obrabljene ali poškodovane medicinske pripomočke in/ali medicinske pripomočke, pri katerih je prišlo do spremembe materiala, pošljite pooblaščenemu servisnemu partnerju W&H.

Ciklusi ponovne priprave



- > Pri medicinskem pripomočku W&H se priporoča izvedba rednega servisa po 500 ciklusih ponovne priprave ali po enem letu.
- > W&H priporoča, da po 100 ciklusih ponovne priprave zamenjate cev za hladilno sredstvo.



Po vsakem posegu takoj očistite medicinski pripomoček, da izperete tekočine (npr. kri, slino ipd.), ki so prodrle v notranjost, in preprečite nabiranje na notranjih delih.

- > Počakajte, da medicinski pripomoček najmanj 10 sekund deluje v prostem teku.
- > Pazite, da izperete vse izstopne odprtine.




> Z dezinfekcijskim sredstvom v celoti obrišite površino instrumenta.

- > Odstranite vrtljivi instrument.
- > Snemite medicinski pripomoček z motorja.




Ne pozabite, da je dezinfekcijsko sredstvo, uporabljeno pri predhodni obdelavi, namenjeno samo osebni zaščiti in ne more nadomestiti postopka dezinfekcije po čiščenju.

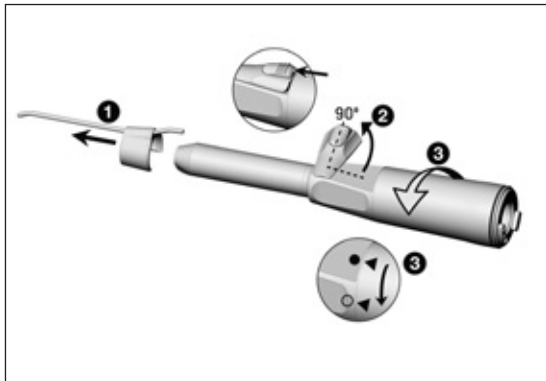

Razstavljanje medicinskega pripomočka

- 1 Snemite cev za hladilno sredstvo.
- 2 Sprostite in obrnite vpenjalno ročico.
- 3 Tulec ročaja odvijte s konice ročnika z enkratnim zasukom.

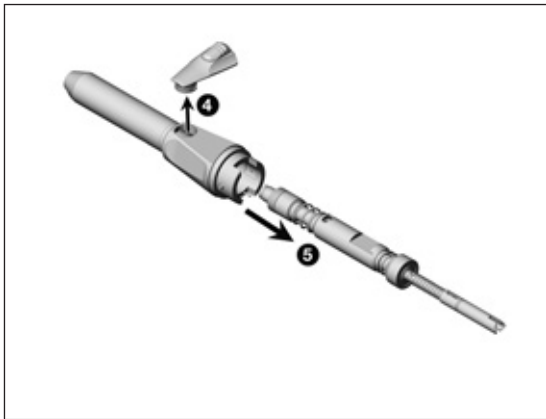


- 4 Snemite vpenjalno ročico.
- 5 Odstranite gred iz konice ročnika.



Medicinskega pripomočka ne polagajte v dezinfekcijsko raztopino ali ultrazvočno kopel!

- > Medicinski pripomoček očistite pod tekočo pitno vodo (< 35 °C/95 °F).
- > Vse notranje in zunanje površine izperite in jih oščetkajte.
- > Premične dele večkrat premaknite sem in tja.
- > S stisnjenim zrakom odstranite ostanke tekočine.

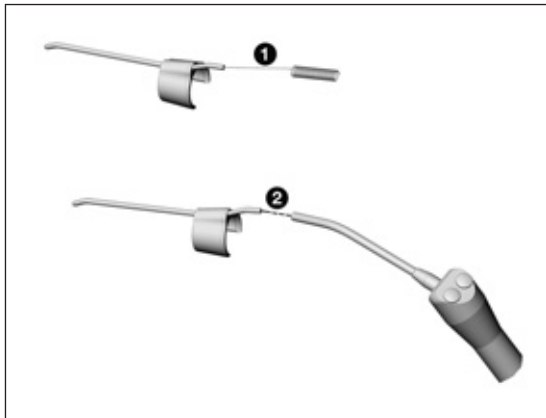

Očistite zunanje cevi za hladilno sredstvo




Snemljivo cev za hladilno sredstvo in čistilnik šob lahko čistite v ultrazvočni kopeli in/ali s pomivalno-dezinfekcijskim strojem.

- 1 Na izstopnih odprtinah previdno očistite umazanijo in usedline s čistilnikom šob.
- 2 S stisnjenim zrakom odmašite cev za hladilno sredstvo.



V primeru zamašenih izstopnih odprtin ali cevi za hladilno sredstvo se obrnite na pooblaščenega servisnega partnerja W&H.

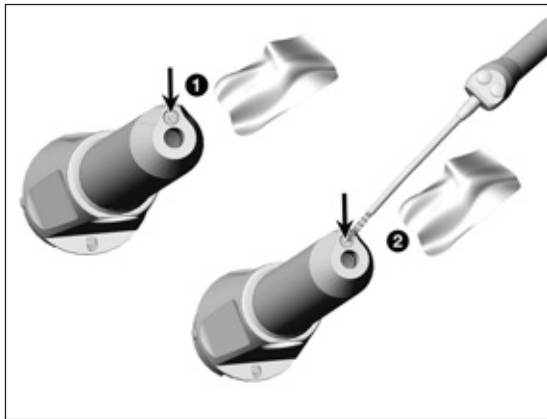

Čiščenje luči LED



Pazite, da luči LED ne opraskate!

- 1 Luč LED očistite s čistilno tekočino in mehko krpo.
- 2 Osušite luč LED s stisnjenim zrakom ali previdno z mehko krpo.



- > Po vsakem čiščenju opravite še pregled naprave.
- > Če je luč LED poškodovana, ne uporabljajte medicinskega pripomočka in se obrnite na pooblaščenega servisnega partnerja W&H.



> W&H priporoča dezinfekcijo z brisanjem.



Splošno primernost medicinskega pripomočka za učinkovito ročno dezinfekcijo je dokazal neodvisni preskusni laboratorij z uporabo dezinfekcijskih sredstev »mikrozid® AF wipes« (podjetja Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt) in »CaviWipes™« (podjetja Metrex).



W&H priporoča strojno čiščenje in dezinfekcijo s pomivalno-dezinfekcijskim strojem.

- > Upoštevajte napotke, navodila in opozorila proizvajalca pomivalno-dezinfekcijskih strojev ter čistilnih in/ali dezinfekcijskih sredstev.



Splošno primernost medicinskega pripomočka za učinkovito strojno dezinfekcijo je dokazal neodvisni preskusni laboratorij z uporabo pomivalno-dezinfekcijskega stroja »Miele PG 8582 CD« [podjetja Miele & Cie. KG, Gütersloh] in čistilnega sredstva »Dr. Weigert neodisher® MediClean forte« [podjetja Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg].

- > Čiščenje pri 55 °C (131 °F) – 5 minut
- > Dezinfekcija pri 93 °C (200 °F) – 5 minut



Strojno čiščenje ter dezinfekcija zunanjih cevi za hladilno sredstvo



Uporabite komplet adapterjev W&H
REF 07233500.

- 1 Privijte adapter W&H v adapter injektorske tirnice.
- 2 Privijte vmesni adapter W&H na adapter W&H.
- 3 Nataknite silikonsko cev W&H na vmesni adapter W&H.
- 4 Vtaknite zunanjo cev za hladilno sredstvo v silikonsko cev W&H.




- > Po čiščenju in dezinfekciji mora biti medicinski pripomoček od zunaj in znotraj popolnoma suh.
- > S stisnjenim zrakom odstranite ostanke tekočine.

Pregled



- > Po čiščenju in dezinfekciji preglejte, ali je medicinski pripomoček poškodovan, ali so na njem ostanki umazanije in ali so na njegovi površini kakšne spremembe.
- > Ponovno pripravite medicinske pripomočke, ki so še vedno umazani.
- > Po čiščenju, dezinfekciji in negi z oljem sterilizirajte sestavljeni medicinski pripomoček.

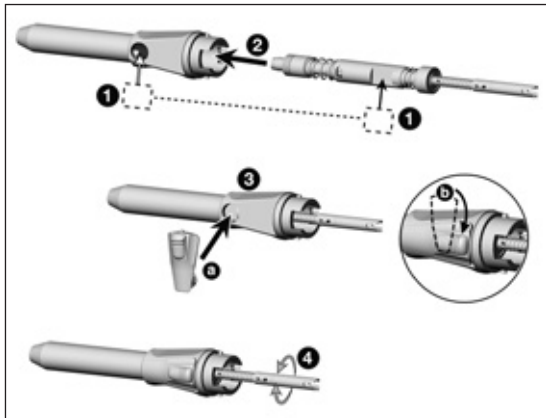


Sestavljanje medicinskega pripomočka



Po čiščenju in dezinfekciji razstavljen medicinski pripomoček ponovno sestavite.

- > Brez cevi za hladilno sredstvo
- > Tipske in serijske številke se morajo ujemati

- ❶ Pazite na pravilen položaj površin vpenjalne ročice.
- ❷ Potisnite gred v konico ročnika.
- ❸ Vstavite vpenjalno ročico [a] in jo zavrtite v izhodiščni položaj [b].
- ❹ Preverite, ali se gred prosto vrti.

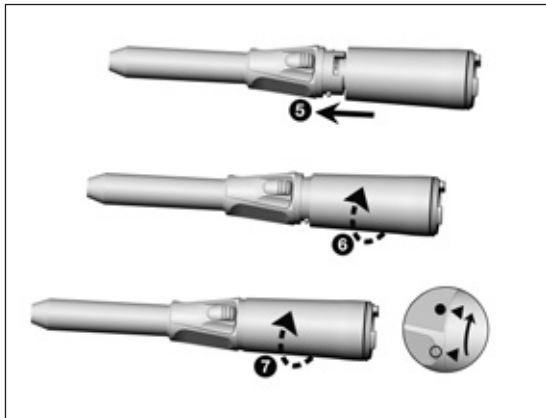

- 5 Natakните tulec ročaja na konico ročnika.
- 6 Zavrtite tulec ročaja, da se slišno zaskoči.
- 7 Pazite na simbole in zavrtite, dokler se ne zaklene.

Nega z oljem



> Takoj po čiščenju in/ali dezinfekciji naoljite suh medicinski pripomoček.

Priporočeni ciklusi negovanja

- > Obvezno po vsakem čiščenju notranjosti
- > Pred vsako sterilizacijo

Z izdelkom W&H Service Oil F1, MD-400

- > Upoštevajte napotke na oljnem razpršilu in na embalaži.
- ali

Z izdelkom W&H Assistina

- > Upoštevajte napotke v navodilih za uporabo izdelka Assistina.

Preverjanje po negi z oljem





- > Obrnite medicinski pripomoček navzdol.
- > Zaženite medicinski pripomoček, da lahko odvečno olje izteče med delovanjem.
- > Olje, ki je morda izteklo, odstranite.
- > Odvečno olje lahko povzroči pregrevanje medicinskega pripomočka.




Zapakirajte medicinski pripomoček in pribor v sterilizacijsko embalažo, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- > Sterilizacijska embalaža mora izpolnjevati zahteve glede kakovosti in uporabe veljavnih standardov ter mora biti primerna za sterilizacijo.
- > Sterilizacijska embalaža mora biti dovolj velika za predmete, ki jih boste sterilizirali.
- > Polna sterilizacijska embalaža ne sme biti preveč napeta.

 W&H priporoča sterilizacijo v skladu s standardom EN 13060, EN 285 ali ANSI/AAMI ST55.

-  > Upoštevajte napotke, navodila in opozorila proizvajalca parnih sterilizatorjev.
- > Izbrani program mora biti primeren za medicinske pripomočke.

-  > Cev za hladilno sredstvo pred sterilizacijo odstranite z medicinskega pripomočka.

-  > Sterilizirajte cev za hladilno sredstvo in medicinski pripomoček.

Priporočeni sterilizacijski cikli

- > Parna sterilizacija (tip B, N)
- > Čas sterilizacije najmanj 3 minute pri 134 °C (273 °F), najmanj 4 minute pri 132 °C (270 °F) oz. najmanj 30 minut pri 121 °C (250 °F)
- > Najvišja temperatura sterilizacije 135 °C (275 °F)



Splošno primernost medicinskega pripomočka za učinkovito sterilizacijo je dokazal neodvisni preskusni laboratorij z uporabo parnega sterilizatorja LISA 517 B17L (podjetja W&H Sterilization S.r.l., Brusaporto (BG)) in parnega sterilizatorja CertoClav MultiControl MC2-S09S273 (podjetja CertoClav GmbH, Traun).

»Dynamic-air-removal prevacuum cycle« (tip B): temperatura 134 °C (273 °F) – 3 minute*
temperatura 132 °C (270 °F) – 4 minute*/**

»Gravity-displacement cycle« (tip N): temperatura 121 °C (250 °F) – 30 minut**

* EN 13060, EN 285, ISO 17665

** ANSI/AAMI ST55, ANSI/AAMI ST79



- > Sterilne predmete shranjujte na suhem mestu, kjer ni prahu.
- > Rok uporabnosti sterilnih predmetov je odvisen od pogojev skladiščenja in vrste embalaže.

6. Servis

Popravilo in vračilo

V primeru motenj v delovanju se takoj obrnite na pooblaščenega servisnega partnerja W&H.

Popravila in vzdrževalna dela smejo izvajati samo pooblaščeni servisni partnerji W&H.



> Zagotovite, da pred vračilom izpeljete celoten postopek ponovne priprave medicinskega pripomočka.

7. Pribor in nadomestni deli W&H



Uporabljajte samo originalni pribor in nadomestne dele W&H ali pribor, ki ga je odobrilo podjetje W&H.

Dobavitelj: partnerji W&H

| | |
|----------|--|
| 000301xx | Assistina 301 plus |
| 30310000 | Assistina TWIN (MB-302) |
| 10940021 | Service Oil F1, MD-400 (6 pcs) |
| 02038200 | Pršilni adapter |
| 00636901 | Dolgi čistilnik šob |
| 06879500 | Cev za hladilno sredstvo za S-11 L |
| 07233500 | Komplet adapterjev za pomivalno-dezinfekcijski stroj |

8. Tehnični podatki

| | | S-11 L |
|------------------------------|----------------------|----------------|
| Prestavno razmerje | | 1 : 1 |
| Barvna oznaka | | modra |
| Dovoljen priključek motorja | [W&H] | EM-19 LC/EM-19 |
| Vrtljivi instrumenti | ISO 1797 (Ø mm) | 2,35* |
| Dovoljena dolžina svedra | [mm] | 45** |
| Najmanjša vpenjalna dolžina | | na omejilo |
| Največje število vrtljajev | [min ⁻¹] | 50.000 |
| Količina hladilnega sredstva | ISO 14457 [ml/min] | > 50 |

min⁻¹ (število vrtljajev na minuto)



* Lahko se uporabi sistem Stryker.

** Pri uporabi daljših ali krajših vrtljivih instrumentov mora uporabnik s pravilno izbiro pogojev obratovanja poskrbeti, da ne ogroža sebe, bolnika ali drugih oseb.

Podatki o temperaturi



| | |
|--|-------------------------|
| Temperatura medicinskega pripomočka na strani upravljalca: | največ 55 °C (131 °F) |
| Temperatura medicinskega pripomočka na strani bolnika: | največ 50 °C (122 °F) |
| Temperatura delujočega dela (vrtljivega instrumenta): | največ 41 °C (105,8 °F) |

Okoljski pogoji

| | |
|--|---|
| Temperatura pri skladiščenju in transportu: | od -40 °C do +70 °C (od -40 °F do +158 °F) |
| Vlažnost zraka pri skladiščenju in transportu: | od 8 do 80 % (relativna), ki ne kondenzira |
| Temperatura pri obratovanju: | od +10 °C do +35 °C (od +50 °F do +95 °F) |
| Vlažnost zraka pri obratovanju: | od 15 do 80 % (relativna), ki ne kondenzira |

9. Odstranjevanje



Zagotovite, da sestavni deli pri odstranjevanju niso kontaminirani.



Upoštevajte lokalne in nacionalne zakone, direktive, standarde in predpise za odstranjevanje.

- > Medicinski pripomoček
- > Stare električne naprave
- > Embalaža

Garancijska izjava

Ta medicinski pripomoček so z največjo skrbnostjo izdelali visoko kvalificirani strokovnjaki. Različni preizkusi in kontrole zagotavljajo brezhibno delovanje. Ne pozabite, da so garancijski zahtevki veljavni le ob upoštevanju vseh navodil iz priloženih navodil za uporabo.

W&H kot proizvajalec jamči, da je izdelek brez napak v materialu in izdelavi od dne nakupa do preteka garancijskega obdobja 24 mesecev. Garancija ne velja za pribor in potrošni material (cev za hladilno sredstvo, čistilnik šob, pršilni adapter, komplet adapterjev).

Ne jamčimo za škodo, nastalo zaradi nestrokovnega ravnanja ali v primeru popravil tretjih oseb, ki niso pooblašcene s strani W&H!

Garancijske zahtevke je treba ob predložitvi računa dostaviti dobavitelju ali pooblaščenemu servisnemu partnerju W&H. Zagotovitev garancijske storitve ne podaljša niti garancije niti morebitnega garancijskega obdobja.

24 mesecev garancije

Pooblašчени servisni partnerji W&H

Obiščite spletno mesto podjetja W&H na <http://wh.com>

Na strani »Service« najdete najbližjega pooblaščenega servisnega partnerja W&H.

Ali pa skenirajte kodo QR.



Proizvajalec

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0,

office@wh.com

f + 43 6274 6236-55

wh.com

Form-Nr. 50884 ASI

Rev. 003 / 17.12.2020

Pridržujemo si pravico do sprememb