

Navodila za uporabo



PEOPLE HAVE PRIORITY



Kirurgija

Ročniki z lučjo
Mini-LED+ in generatorjem
S-9 L G, S-11 L G

Ročniki brez luči
S-9, S-10, S-11, S-12, S-15, S-16

Kazalo

Simboli	4
v navodilih za uporabo	4
na medicinskem pripomočku/na embalaži	5
1. Uvod	6
2. Varnostni napotki	9
3. Opis izdelka	14
4. Zagon	16
Natikanje/snemanje	16
Vrtljivi instrumenti	18
Zamenjava vrtljivega instrumenta	19
Poskusni zagon	20
5. Higiena in nega	21
Splošni napotki.....	21
Omejitev pri pripravi	23

Prva uporaba na mestu uporabe	24
Ročno čiščenje	25
Ročna dezinfekcija	33
Strojno čiščenje in dezinfekcija.....	34
Sušenje	36
Pregled, nega in preverjanje	37
Embalaža	44
Sterilizacija	45
Skladiščenje	47
6. Servis	48
7. Pribor in nadomestni deli W&H	49
8. Tehnični podatki	50
9. Odstranjevanje	53
Garancijska izjava	54
Pooblaščen servisni partnerji W&H.....	55



OPOZORILO!

(če obstaja nevarnost
telesnih poškodb)



POZOR!

(če obstaja nevarnost
poškodovanja stvari)



Splošna pojasnila,
brez nevarnosti za
človeka ali stvari



Ne zavržite med
gospodinjske odpadke

R_x_{only}

Pozor!

V skladu z ameriško zakonodajo se sme v Združenih državah Amerike ta medicinski pripomoček prodati samo zobozdravniku, zdravniku ali drugi osebi z ustrežno medicinsko izobrazbo, ki ima v zvezni državi, v kateri izvaja svojo prakso, ustrežno licenco in bo ta medicinski pripomoček tudi uporabljala ali njeno uporabo odobrila.

Simboli

na medicinskem pripomočku/na embalaži

	Oznaka CE z identifikacijsko številko priglašene organa		DataMatrix Code za informacije o izdelku vključno z UDI (Unique Device Identification)		Struktura podatkov v skladu s Health Industry Bar Code
	Številka izdelka		Možnost termične dezinfekcije		Možnost sterilizacije do navedene temperature
	Serijska številka		Oznaka kakovosti UL za priznane sestavne dele za Kanado in ZDA		Medicinski pripomoček
	Datum izdelave				

1. Uvod

Politika kakovosti je pri W&H oblikovana tako, da je zadovoljstvo strank vselej na prvem mestu. Predstavljen medicinski pripomoček smo razvili, izdelali in preizkusili v skladu z veljavnimi zakonskimi in normativnimi predpisi.

Za vašo varnost in varnost vaših bolnikov

Preden začnete uporabljati izdelek, preberite navodila za uporabo. Ta vam bodo pojasnila rokovanje z medicinskim pripomočkom ter omogočila brezhibno, gospodarno in varno uporabo.



Upoštevajte varnostne napotke.

Namen uporabe

Kirurška obdelava organske trde substance.



Uporaba, ki ni v skladu z namembnostjo, lahko privede do poškodb medicinskega pripomočka ter s tem povzroči tveganje ter nevarnost za bolnika, uporabnika in druge osebe.

Usposobljenost uporabnika

Pri razvoju in konstruiranju medicinskega pripomočka smo izhajali iz ciljne skupine zdravniki.

Izdelava v skladu z direktivo EU



0297

Medicinski pripomoček je v skladu z določili Direktive 93/42/EGS.

Odgovornost proizvajalca

Proizvajalec je odgovoren za učinke na varnost, zanesljivost in delovanje medicinskega pripomočka samo v primeru, da je bila naprava uporabljena v skladu z naslednjimi navodili:

- > Medicinski pripomoček morate uporabljati v skladu s temi navodili za uporabo.
- > Medicinski pripomoček ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih lahko uporabnik popravil sam.
- > Spremembe ali popravila smejo izvajati samo pooblaščenji servisni partnerji W&H (glejte stran 55).

Strokovna uporaba

Medicinski pripomoček je namenjen izključno strokovni uporabi za predvideni namen ob upoštevanju veljavnih predpisov za varstvo pri delu, ukrepov za preprečevanje nesreč in teh navodil za uporabo.

Medicinski pripomoček lahko pripravljajo in vzdržujejo le osebe, ki so seznanjene s področjem zaščite pred infekcijami, samozaščite in zaščite bolnikov.

Ob ugotovljeni nestrokovni uporabi (npr. zaradi pomanjkljive higiene in nege), neupoštevanju navodil ali uporabi neodobrenega pribora ali nadomestnih delov podjetje W&H ni zavezano k izpolnitvi kakršnih koli garancijskih zahtevkov ali zahtevkov druge vrste.



O kakršnih koli hudih nezgodah, povezanih z medicinskim pripomočkom, je treba obvestiti proizvajalca in pristojne organe!

2. Varnostni napotki



- > Medicinski pripomoček pred uporabo 24 ur hranite pri sobni temperaturi.
- > Uporaba medicinskega pripomočka je dovoljena le skupaj z oskrbovalnimi enotami, ki izpolnjujejo zahteve standardov IEC 60601-1 (EN 60601-1) in IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2).
- > Vedno poskrbite za primerne delovne pogoje in se prepričajte, da je hladilno sredstvo pripravljeno.
- > Vedno imejte pripravljeno zadostno količino ustreznega hladilnega sredstva in poskrbite za primerno odsesavanje.
- > V primeru izpada oskrbe s hladilnim sredstvom nemudoma zaustavite medicinski pripomoček.
- > Pred vsako uporabo se prepričajte, da medicinski pripomoček ni poškodovan in da so vsi deli primerno pritrjeni.
- > Če je medicinski pripomoček poškodovan, ga ne uporabljajte.
- > Medicinski pripomoček natakните samo, ko motor miruje.
- > Pred vsako uporabo izvedite poskusni zagon.
- > Pazite, da na mestu posega ne pride do pregrevanja.



- > Z glavo ročnika se ne dotikajte mehkega tkiva (nevarnost opeklin)!
- > Preprečite stik med lučjo LED in mehкими tkivi (nevarnost opeklin zaradi segretja luči LED).
- > Medicinskega pripomočka ne uporabljajte kot svetlobno sondo.
- > Ne glejte neposredno v vir svetlobe.



Medicinski pripomoček ni primeren za uporabo v območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.



Medicinski pripomoček ima občutno izboljšano stopnjo učinkovitosti v primerjavi z običajnimi kolenčniki ter je usklajen z W&H pogonskimi enotami Implantmed SI-9xx, SI-10xx, Elcomed SA-2xx in SA-3xx.

Pri uporabi pogonskih enot, ki niso usklajene z medicinskim pripomočkom, je treba potreben navor zmanjšati na približno polovico. To pomeni: za doseganje 50 Ncm pri vrtljivem instrumentu je treba npr. pri W&H Elcomed 100/200 treba navor na 30 Ncm.

Uporaba medicinskega pripomočka na drugih kirurških enotah, ki niso Implantmed SI-9xx, SI-10xx, Elcomed SA-2xx in SA-3xx, še posebej pri tistih brez funkcije kalibriranja, predstavlja tveganje, ki ga mora oceniti uporabnik (nevarnost telesnih poškodb). W&H to odločno odsvetuje. Odgovornost nosi izključno uporabnik. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

Tveganja zaradi elektromagnetnih polj



Električna, magnetna in elektromagnetna polja lahko vplivajo na delovanje implantiranih sistemov, kot sta srčni spodbujevalnik in vsadni kardioverter oziroma defibrilator.

- > Pred uporabo medicinskega pripomočka pri bolniku in uporabniku preverite, ali imata implantirane sisteme, ter preverite vstavek.
- > Pretehtajte tveganje uporabe.
- > Medicinskega pripomočka ne približujte implantiranim sistemom.
- > Pripravite se za ukrepanje v sili in se takoj odzovite na vsako zdravstveno spremembo.
- > Simptomi, kot so povišan srčni utrip, neenakomeren pulz in vrtoglavica, so lahko znak za težave s srčnim spodbujevalnikom ali vsadnim kardioverterjem oziroma defibrilatorjem.

Higiena in nega pred prvo uporabo




- > Medicinski pripomoček je ob dobavi zavarjen v polietilensko folijo in ni steriliziran.
- > Polietilenske folije in embalaže ni mogoče sterilizirati.



- > Medicinski pripomoček očistite, dezinficirajte in naoljite.
- > Sterilizirajte medicinski pripomoček, čistilnik šob in cev za hladilno sredstvo.

3. Opis izdelka


S-11 L G, S-11, S-15

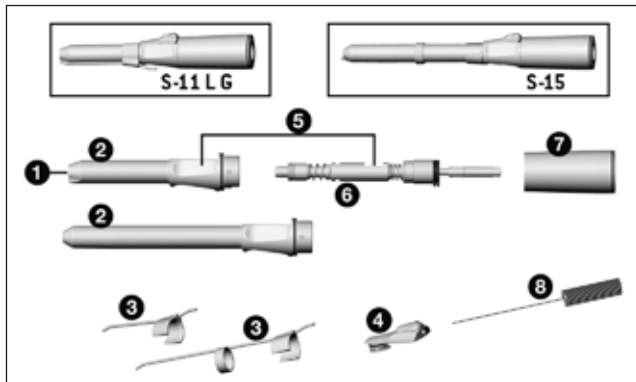

- 1 Luč LED (samo S-11 L G)
- 2 Konica ročnika*
- 3 Cev za hladilno sredstvo (nastavljiva)
- 4 Vpenjalna ročica
- 5 Površine vpenjalne ročice
- 6 Gred
- 7 Tulec ročaja*
- 8 Dolgi čistilnik šob

* Simboli na delih 2 in 7


- ☰ Odprt tulec ročaja
- ↔ Smer vrtenja
- ⌘ Zaklenjen tulec ročaja

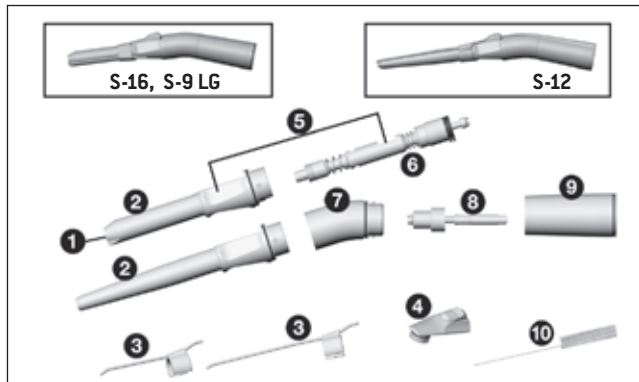

- ❶ Luč LED (samo S-9 L G)
- ❷ Konica ročnika*
- ❸ Cev za hladilno sredstvo (nastavljiva)
- ❹ Vpenjalna ročica
- ❺ Površine vpenjalne ročice
- ❻ Gred
- ❼ Koleno*
- ❽ Sojemalna gred
- ❾ Tulec ročaja*
- ❿ Dolgi čistilnik šob


* Simboli na delih ❷, ❹ in ❾

- Odprt tulec ročaja
- ↔ Smer vrtenja
- ▲ Zaklenjen tulec ročaja

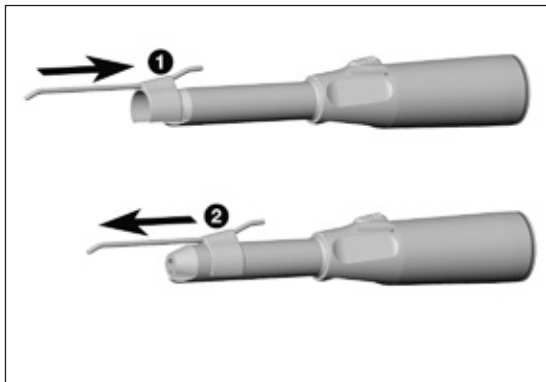

Cev za hladilno sredstvo

- 1 Natakните cev za hladilno sredstvo.
ali
- 2 Snemite cev za hladilno sredstvo.

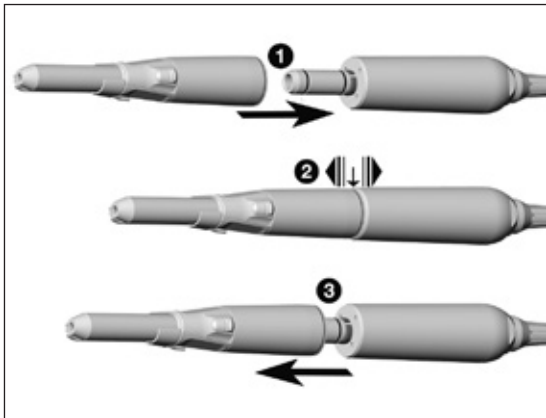

Medicinski pripomoček



Medicinskega pripomočka ne natakajte ali snemajte med delovanjem!

❶ Medicinski pripomoček nataknete na motor.



Pri uporabi varovala pred obračanjem med motorjem in medicinskim pripomočkom: glejte navodila za uporabo krmilne naprave.



❷ Preverite primerno pritrjenost.

❸ Snemite medicinski pripomoček.


Vrtljivi instrumenti



- > Uporabljajte le brezhibne vrtljive instrumente in pazite na smer vrtenja vrtljivega instrumenta. Upoštevajte navodila proizvajalca.
- > Vrtljivi instrument vstavite le, ko medicinski pripomoček miruje.
- > Nikoli ne segajte v še vrteči ali ustavljajoči se vrtljivi instrument.
- > V nobenem primeru ne pritisnite vpenjalne ročice medicinskega pripomočka med delovanjem. S tem namreč sprostite vrtljivi instrument oziroma povzročite poškodbo vpenjalnega sistema in/ali segrevanje medicinskega pripomočka. Nevarnost opeklin!



- > Pri navoru na vrtljivem instrumentu, ki presega 30 Ncm, je treba uporabiti kaljena stebila svedrov (> 50 HRC, > 520 HV) (nevarnost deformacije).

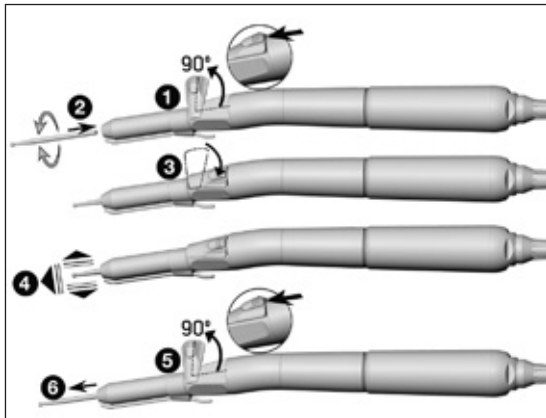

Zamenjava vrtljivega instrumenta

- 1** Sprostite in obrnite vpenjalno ročico.
- 2** Potisnite vrtljivi instrument do omejila.
- 3** Vpenjalno ročico premaknite v izhodiščni položaj.



- 4** Preverite primerno pritrjenost.
ali

- 5** Sprostite in obrnite vpenjalno ročico.
- 6** Odstranite vrtljivi instrument.

Poskusni zagon



Medicinskega pripomočka ne držite v višini oči!

- > Vstavite vrtljivi instrument.
- > Zaženite medicinski pripomoček.



V primeru motenj v delovanju (npr. vibracij, nenavadnih zvokov, segrevanja, izpada hladilnega sredstva oziroma puščanja) **nemudoma zaustavite medicinski pripomoček** in se obrnite na pooblaščenega servisnega partnerja W&H.



> Upoštevajte lokalne in nacionalne zakone, direktive, standarde in predpise za čiščenje, dezinfekcijo in sterilizacijo.



> Nosite zaščitno obleko, zaščitna očala, zaščitno masko in rokavice.



> Za ročno sušenje uporabljajte samo filtriran stisnjen zrak brez vsebnosti olja z obratovalnim tlakom največ 3 bare.

Čistilna in dezinfekcijska sredstva



- > Upoštevajte napotke, navodila in opozorila proizvajalca čistilnih in/ali dezinfekcijskih sredstev.
- > Uporabljajte samo detergente, ki so predvideni za čiščenje in/ali dezinfekcijo medicinskih pripomočkov iz kovine in umetne mase.
- > Obvezno morate upoštevati koncentracije in čase učinkovanja, ki jih je navedel proizvajalec dezinfekcijskega sredstva.
- > Uporabljajte dezinfekcijska sredstva, ki so preizkušena in ocenjena kot učinkovita s strani organizacij, kot so Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH = Združenje za uporabno higieno), Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP = Avstrijsko društvo za higieno, mikrobiologijo in preventivno medicino), Food and Drug Administration (FDA = Agencija za hrano in zdravila) in U.S. Environmental Protection Agency (EPA = Ameriška agencija za zaščito okolja).



Če navedena čistilna in dezinfekcijska sredstva niso na voljo, je odgovornost uporabnika, da validira svoje postopke.



Na življenjsko dobo in delovanje medicinskega pripomočka odločilno vplivata mehanska obremenitev pri uporabi in kemični vplivi pri pripravi.

- > Obrabljene ali poškodovane medicinske pripomočke in/ali medicinske pripomočke, pri katerih je prišlo do spremembe materiala, pošljite pooblaščenemu servisnemu partnerju W&H.

Ciklusi priprave



- > Pri medicinskem pripomočku W&H se priporoča izvedba rednega servisa po 500 ciklusih priprave ali po enem letu.
- > W&H priporoča, da po 100 ciklusih priprave zamenjate cev za hladilno sredstvo.



Po vsakem posegu takoj očistite medicinski pripomoček, da izperete tekočine (npr. kri, slino ipd.), ki so morda prodrle v notranjost, in preprečite nabiranje na notranjih delih.

- > Počakajte, da medicinski pripomoček najmanj 10 sekund deluje v prostem teku.
- > Pazite, da izperete vse izstopne odprtine.




> Medicinski pripomoček v celoti obrišite z dezinfekcijskim sredstvom.

- > Odstranite vrtljivi instrument.
- > Snemite medicinski pripomoček.




Ne pozabite, da je dezinfekcijsko sredstvo, uporabljeno pri predhodni obdelavi, namenjeno samo osebni zaščiti in ne more nadomestiti postopka dezinfekcije po čiščenju.

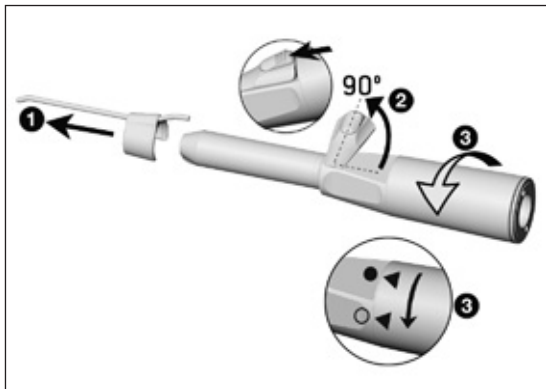


Razstavljanje ravnega medicinskega pripomočka S-11 L G, S-11, S-15

- 1 Snemite cev za hladilno sredstvo.
- 2 Sprostite in obrnite vpenjalno ročico.
- 3 Tulec ročaja odvijte s konice ročnika z enkratnim zasukom.

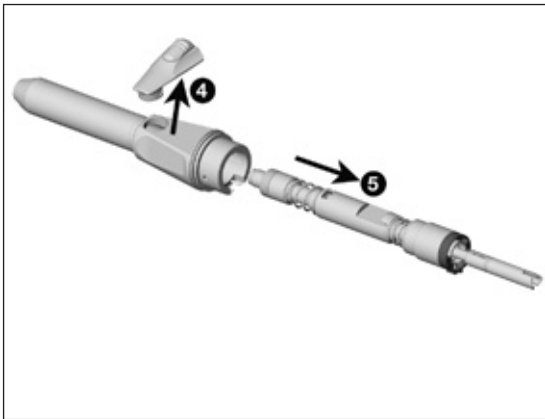


- 4 Snemite vpenjalno ročico.
- 5 Odstranite gred iz konice ročnika.

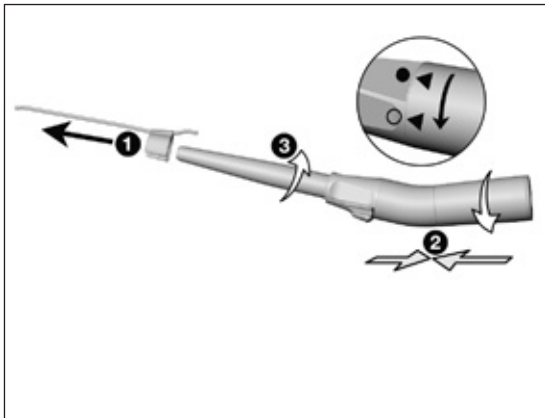

Razstavljanje ukrivljenega medicinskega pripomočka S-9 L G, S-9, S-10, S-12, S-16

- 1 Snemite cev za hladilno sredstvo.
- 2 Tulec ročaja močno potisnite proti kolenu.
- 3 Tulec ročaja odvijte s konice ročnika z enkratnim zasukom.

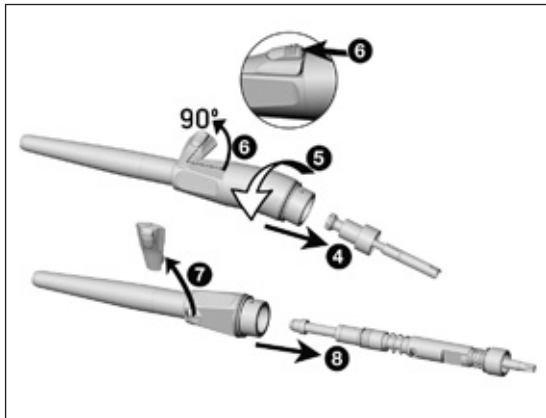


- 4 Odstranite sojemalno gred iz kolena.
- 5 Koleno odvijte s konice ročnika.
- 6 Sprostite in obrnite vpenjalno ročico.
- 7 Gred povlecite do omejila nazaj in izvlecite vpenjalno ročico.
- 8 Odstranite gred iz konice ročnika.



Medicinskega pripomočka ne polagajte v dezinfekcijsko raztopino ali ultrazvočno kopel!

- > Medicinski pripomoček očistite pod tekočo pitno vodo [$< 35\text{ °C}/95\text{ °F}$].
- > Vse notranje in zunanje površine izperite in jih oščetkajte.
- > Premične dele večkrat premaknite sem in tja.
- > S stisnjanim zrakom odstranite ostanke tekočine.

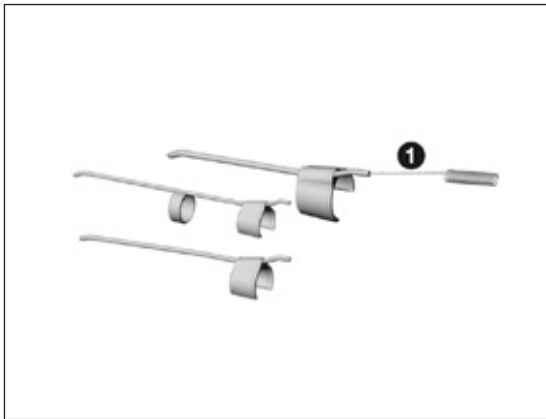

Očistite zunanje cevi za hladilno sredstvo




Cev za hladilno sredstvo lahko pripravite v ultrazvočni kopeli in/ali s pomivalno-dezinfekcijskim strojem.



Čistilnik šob lahko čistite v ultrazvočni kopeli in/ali s pomivalno-dezinfekcijskim strojem.




Na izstopnih odprtinah previdno očistite umazanijo in usedline s čistilnikom šob.

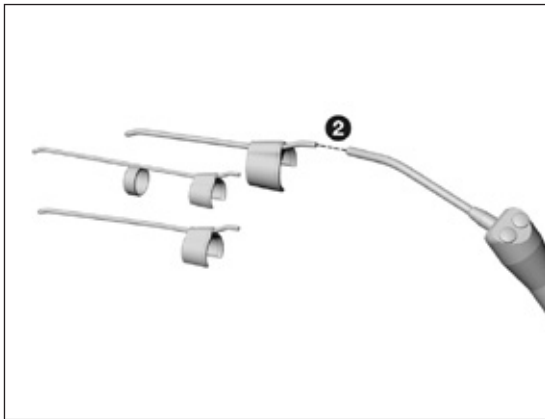

2 S stisnjenim zrakom odmašite cev za hladilno sredstvo in izstopne odprtine.




V primeru zamašenih izstopnih odprtín ali cevi za hladilno sredstvo se obrnite na pooblaščenega servisnega partnerja W&H.

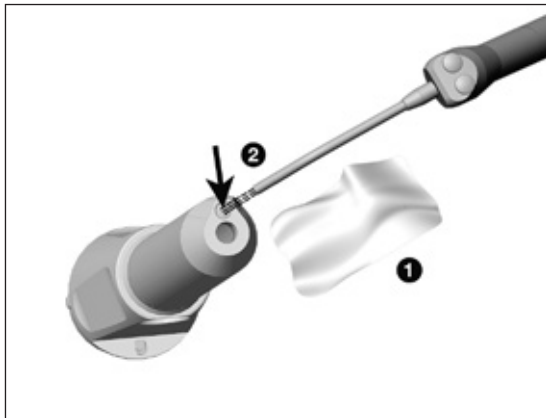

Čiščenje vira svetlobe S-9 L G, S-11 L G



Pazite, da vira svetlobe ne opraskate!

- 1 Luč LED očistite s čistilno tekočino in mehko krpo.
 - 2 Osušite luč LED s stisnjenim zrakom ali previdno z mehko krpo.
-  > Po vsakem čiščenju opravite še pregled naprave.
- > Če je vir svetlobe poškodovan, medicinskega pripomočka ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega servisnega partnerja W&H.



> W&H priporoča dezinfekcijo z brisanjem.



Splošno primernost medicinskega pripomočka za učinkovito ročno dezinfekcijo je dokazal neodvisni preskusni laboratorij z uporabo dezinfekcijskih sredstev »mikrozid® AF wipes« (podjetja Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt) in »CaviWipes™« (podjetja Metrex).



W&H priporoča strojno čiščenje in dezinfekcijo s pomivalno-dezinfekcijskim strojem.

- > Upoštevajte napotke, navodila in opozorila proizvajalca pomivalno-dezinfekcijskih strojev ter čistilnih in/ali dezinfekcijskih sredstev.



Splošno primernost medicinskega pripomočka za učinkovito strojno dezinfekcijo je v skladu s standardom ISO 15883 dokazal neodvisni preskusni laboratorij z uporabo pomivalno-dezinfekcijskega stroja »Miele PG 8582 CD« (Miele & Cie. KG, Gütersloh) in čistilnega sredstva »Dr. Weigert neodisher® MediClean forte« (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg).

- > Čiščenje pri 55 °C (131 °F) – 5 minut
- > Dezinfekcija pri 93 °C (200 °F) – 5 minut



Strojno čiščenje ter dezinfekcija zunanjih cevi za hladilno sredstvo



Uporabite komplet adapterjev W&H
REF 07233500.

- 1 Privijte adapter W&H v adapter injektorske tirnice.
- 2 Privijte vmesni adapter W&H na adapter W&H.
- 3 Nataknite silikonsko cev W&H na vmesni adapter W&H.
- 4 Vtaknite zunanjo cev za hladilno sredstvo v silikonsko cev W&H.




- > Po čiščenju in dezinfekciji mora biti medicinski pripomoček od zunaj in znotraj popolnoma suh.
- > S stisnjenim zrakom odstranite ostanke tekočine.

Pregled



- > Po čiščenju in dezinfekciji preglejte, ali je medicinski pripomoček poškodovan, ali so na njem ostanki umazanije in ali so na njegovi površini kakšne spremembe.
- > Ponovno pripravite medicinske pripomočke, ki so še vedno umazani.
- > Po čiščenju, dezinfekciji in negi z oljem sterilizirajte sestavljeni medicinski pripomoček.

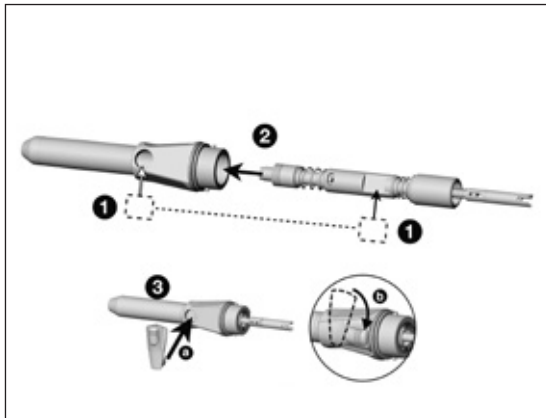


Sestavljanje ravnega medicinskega pripomočka S-11 L G, S-11, S-15




Po čiščenju in dezinfekciji razstavljen medicinski pripomoček ponovno sestavite.

- > Brez cevi za hladilno sredstvo
- > Tipske in serijske številke se morajo ujemati

- ❶ Pazite na pravilen položaj površin vpenjalne ročice.
- ❷ Potisnite gred v konico ročnika.
- ❸ Vstavite vpenjalno ročico [a] in jo zavrtite v izhodiščni položaj [b].
Samo S-11 L G: Zlati stiki gredi in konice ročnika se morajo prekrivati.

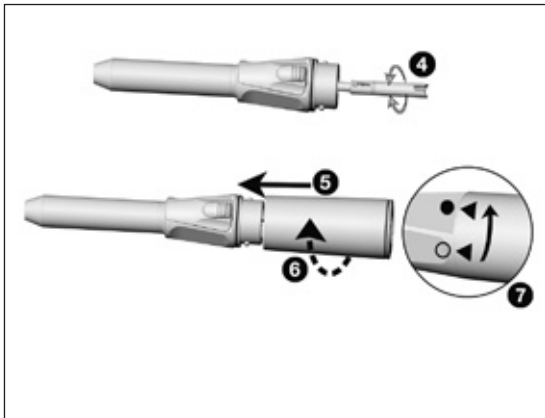

- 4 Pritisnite gred v konico ročnika.
Preverite, ali se gred prosto vrti.
- 5 Nataknite tulec ročaja na konico ročnika.
- 6 Zavrtite tulec ročaja, da se slišno zaskoči.
- 7 Pazite na simbole in zavrtite, dokler se ne zaklene.

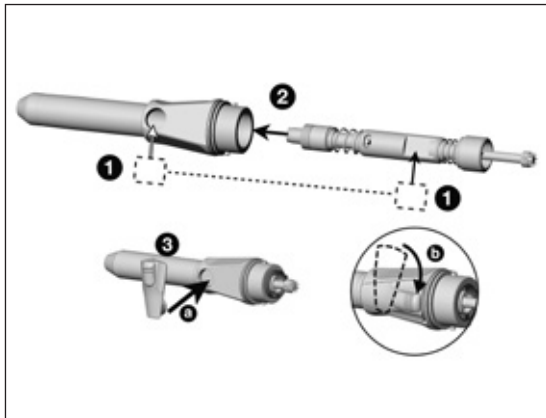

Sestavljanje ukrivljenega medicinskega pripomočka S-9 L G, S-9, S-10, S-12, S-16




Po čiščenju in dezinfekciji razstavljen medicinski pripomoček ponovno sestavite.

- > Brez cevi za hladilno sredstvo
- > Tipske in serijske številke se morajo ujemati

- ❶ Pazite na pravilen položaj površin vpenjalne ročice.
- ❷ Potisnite gred v konico ročnika.
- ❸ Vstavite vpenjalno ročico [a] in jo zavrtite v izhodiščni položaj [b].

Samo S-9 L G: Zlati stiki gredi in konice ročnika se morajo prekrivati.

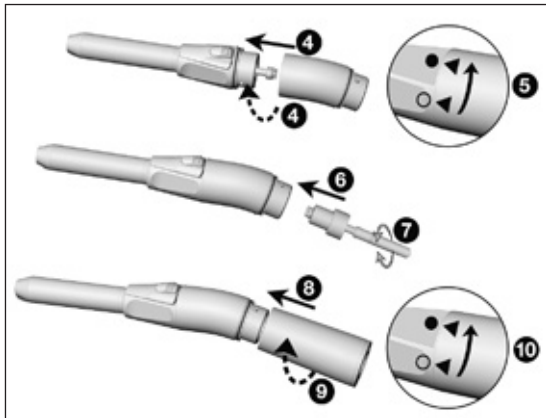

- 4 Pritisnite gred v konico ročnika. Nataknite koleno na konico ročnika.
- 5 Pazite na simbole in zavrtite, dokler se ne zaklene.
- 6 Vstavite sojemalno gred v koleno.
- 7 Preverite, ali se sojemalna gred prosto vrti.
- 8 Nataknite tulec ročaja na koleno.
- 9 Zavrtite tulec ročaja, da se slišno zaskoči.
- 10 Pazite na simbole in zavrtite, dokler se ne zaklene.

Nega z oljem



> Takoj po čiščenju in/ali dezinfekciji naoljite suh medicinski pripomoček.

Priporočeni ciklusi negovanja

- > Obvezno po vsakem čiščenju notranjosti
- > Pred vsako sterilizacijo

Z izdelkom W&H Service Oil F1, MD-400

- > Upoštevajte napotke na oljnem razpršilu in na embalaži.
- ali

Z izdelkom W&H Assistina

- > Upoštevajte napotke v navodilih za uporabo izdelka Assistina.

Preverjanje po negi z oljem





- > Obrnite medicinski pripomoček navzdol.
- > Zaženite medicinski pripomoček, da lahko odvečno olje izteče med delovanjem.
- > Olje, ki je morda izteklo, odstranite.
- > Odvečno olje lahko povzroči pregrevanje medicinskega pripomočka.





Zapakirajte medicinski pripomoček in pribor v sterilizacijsko embalažo, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- > Sterilizacijska embalaža mora izpolnjevati zahteve glede kakovosti in uporabe veljavnih standardov ter mora biti primerna za sterilizacijo.
- > Sterilizacijska embalaža mora biti dovolj velika za predmete, ki jih boste sterilizirali.
- > Polna sterilizacijska embalaža ne sme biti preveč napeta.

 W&H priporoča sterilizacijo v skladu s standardom EN 13060, EN 285 ali ANSI/AAMI ST79.

-  > Upoštevajte napotke, navodila in opozorila proizvajalca parnih sterilizatorjev.
- > Izbrani program mora biti primeren za medicinske pripomočke.

-  > Cev za hladilno sredstvo pred sterilizacijo odstranite z medicinskega pripomočka.

-  > Sterilizirajte cev za hladilno sredstvo in medicinski pripomoček.

Priporočeni sterilizacijski cikli

- > Parna sterilizacija (tip B, N)
- > Čas sterilizacije najmanj 3 minute pri 134 °C (273 °F), najmanj 4 minute pri 132 °C (270 °F) oz. najmanj 30 minut pri 121 °C (250 °F)
- > Najvišja temperatura sterilizacije 135 °C (275 °F)



Splošno primernost medicinskega pripomočka za učinkovito sterilizacijo je dokazal neodvisni preskusni laboratorij z uporabo parnega sterilizatorja LISA 517 B17L (podjetja W&H Sterilization S.r.l., Brusaporto (BG)) in parnega sterilizatorja CertoClav MultiControl MC2-S09S273 (podjetja CertoClav GmbH, Traun).

»Dynamic-air-removal prevacuum cycle« (tip B): temperatura 134 °C (273 °F) – 3 minute*
temperatura 132 °C (270 °F) – 4 minute*/**

»Gravity-displacement cycle« (tip N): temperatura 121 °C (250 °F) – 30 minut**

* EN 13060, EN 285, ISO 17665

** ANSI/AAMI ST55, ANSI/AAMI ST79



- > Sterilne predmete shranjujte na suhem mestu, kjer ni prahu.
- > Rok uporabnosti sterilnih predmetov je odvisen od pogojev skladiščenja in vrste embalaže.

6. Servis

Popravilo in vračilo

V primeru motenj v delovanju se takoj obrnite na pooblaščenega servisnega partnerja W&H.

Popravila in vzdrževalna dela smejo izvajati samo pooblaščeni servisni partnerji W&H.



> Zagotovite, da pred vračilom izpeljete celoten postopek priprave medicinskega pripomočka.

7. Pribor in nadomestni deli W&H



Uporabljajte samo originalni pribor in nadomestne dele W&H ali pribor, ki ga je odobrilo podjetje W&H.

Dobavitelj: Partnerji W&H

000301xx	Assistina 301 plus
30310000	Assistina TWIN (MB-302)
07233500	Komplet adapterjev za pomivalno-dezinfekcijski stroj
10940021	Service Oil F1, MD-400 (6 pcs)
02038200	Pršilni adapter
00636901	Dolgi čistilnik šob
07978680	Cev za hladilno sredstvo za S-9, S-11, S-16
08026210	Cev za hladilno sredstvo za S-10, S-12
08026950	Cev za hladilno sredstvo za S-15

8. Tehnični podatki

	S-11 L G	S-11	S-15
Prestavno razmerje	1:1	1:1	1:1
Barvna oznaka	modra	modra	modra
Priključek motorja v skladu s standardom	ISO 3964	ISO 3964	ISO 3964
Vrtljivi instrumenti ISO 1797 (\emptyset mm)	2,35*	2,35*	2,35*
Dovoljena dolžina svedra (mm)	45**	45**	45**
Najmanjša dolžina vpetja	na omejilo	na omejilo	na omejilo
Največje število vrtljajev (min^{-1})	40.000	50.000	30.000
Količina hladilnega sredstva ISO 14457 (ml/min)	> 50	> 50	> 50

min^{-1} (število vrtljajev na minuto)



* Lahko se uporabi sistem Stryker.

** Pri uporabi daljših ali krajših vrtljivih instrumentov mora uporabnik s pravilno izbiro pogojev obratovanja poskrbeti, da ne ogroža sebe, bolnika ali drugih oseb.

Tehnični podatki

	S-9 L G/S-9	S-10	S-12	S-16
Prestavno razmerje	1:1	1:1	1:2	1:2
Barvna oznaka	modra	modra	oranžna	oranžna
Priključek motorja v skladu s standardom	ISO 3964	ISO 3964	ISO 3964	ISO 3964
Vrtljivi instrumenti ISO 1797 (∅ mm)	2,35*	2,35	2,35	2,35*
Dovoljena dolžina svedra (mm)	45**	70**	70**	45**
Najmanjša dolžina vpetja	na omejilo	na omejilo	na omejilo	na omejilo
Največje število vrtljajev (min ⁻¹)	40.000/50.000	50.000	40.000	40.000
Količina hladilnega sredstva ISO 14457 (ml/min)	> 50	> 50	> 50	> 50

min⁻¹ (število vrtljajev na minuto)



* Lahko se uporabi sistem Stryker.

** Pri uporabi daljših ali krajših vrtljivih instrumentov mora uporabnik s pravilno izbiro pogojev obratovanja poskrbeti, da ne ogroža sebe, bolnika ali drugih oseb.

Podatki o temperaturi



Temperatura medicinskega pripomočka na strani upravljavca:	največ 55 °C (131 °F)
Temperatura medicinskega pripomočka na strani bolnika:	največ 50 °C (122 °F)
Temperatura delujočega dela (vrtljivega instrumenta):	največ 41 °C (105,8 °F)

Okoljski pogoji

Temperatura pri skladiščenju in transportu:	od -40 °C do +70 °C (od -40 °F do +158 °F)
Vlažnost zraka pri skladiščenju in transportu:	od 8 do 80 % (relativna), ki ne kondenzira
Temperatura pri obratovanju:	od +10 °C do +35 °C (od +50 °F do +95 °F)
Vlažnost zraka pri obratovanju:	od 15 do 80 % (relativna), ki ne kondenzira

9. Odstranjevanje



Zagotovite, da sestavni deli pri odstranjevanju niso kontaminirani.



Upoštevajte lokalne in nacionalne zakone, direktive, standarde in predpise za odstranjevanje.

- > Medicinski pripomoček
- > Stare električne naprave
- > Embalaža

Garancijska izjava

Ta medicinski pripomoček W&H so z največjo skrbnostjo izdelali visoko kvalificirani strokovnjaki. Različni preizkusi in kontrole zagotavljajo brezhibno delovanje. Ne pozabite, da so garancijski zahtevki veljavni le ob upoštevanju vseh navodil iz priloženih navodil za uporabo.

W&H kot proizvajalec jamči, da je izdelek brez napak v materialu in izdelavi od dne nakupa do preteka garancijskega obdobja 12 mesecev. Garancija ne velja za pribor in potrošni material (cev za hladilno sredstvo, čistilnik šob, pršilni adapter, komplet adapterjev).

Ne jamčimo za škodo, nastalo zaradi nestrokovnega ravnanja ali v primeru popravil tretjih oseb, ki niso pooblašcene s strani W&H!

Garancijske zahtevke – ob predložitvi računa – je treba dostaviti dobavitelju ali pooblaščenemu servisnemu partnerju W&H. Zagotovitev garancijske storitve ne podaljša niti garancije niti morebitnega garancijskega obdobja.

12 mesecev garancije

Pooblašчени servisni partnerji W&H

Obiščite spletno mesto podjetja W&H na <http://wh.com>

Na strani »Service« najdete najbližjega pooblaščenega servisnega partnerja W&H.

Ali pa skenirajte kodo QR.



Proizvajalec

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0,

office@wh.com

f + 43 6274 6236-55

wh.com

Form-Nr. 50754 ASI

Rev. 003 / 16.06.2020

Pridržujemo si pravico do sprememb.