


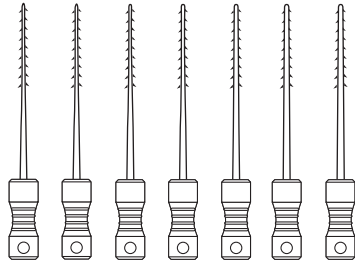
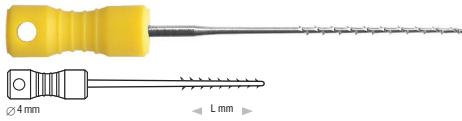





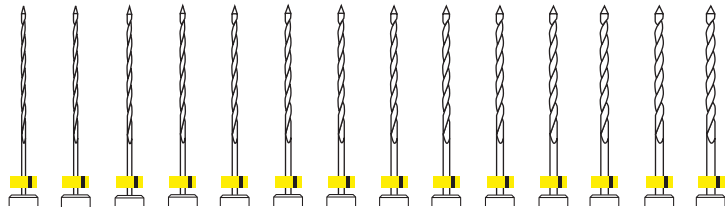

9107   
 Nervnadeln
 Nerve broaches
 Tire - nerfs



Shank	ISO	Order No.	ISO	020	025	030	035	040	050	060	
654	L=11	340 654 657 455 ...	9107.11.654. ...	6	020	025	030	035	040	050	060
		Assortment	9107.11.654S01	1		025	030	035	040	050	060

Manuelle Aufbereitung: Die Nervnadeln in den Wurzelkanal einführen und nach einer Drehung 180° bis 360° mit dem umwickelten Pulpagewebe herausziehen.
 Manual preparation: insert the nerve broach into the root canal and withdraw the engaged pulp by turning it from 180° to 360°.
 Préparation manuelle: insérer le tire - nerf dans le canal radiculaire et retirer l'instrument enveloppé de la pulpe après avoir effectué une rotation de 180° à 360°.



171   
 K - Bohrer
 K - Reamer
 Broche „K“



Shank	ISO	Order No.	ISO	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	
654	L=21	340 654 639 451 ...	171.21.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
		Assortments	171.21.654S01	1			015	020	025	030	035	040						
			171.21.654S02	1								045	050	055	060	070	080	
654	L=25	340 654 640 451 ...	171.25.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
		Assortments	171.25.654S01	1			015	020	025	030	035	040						
			171.25.654S02	1								045	050	055	060	070	080	
654	L=28	340 654 641 451 ...	171.28.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
		Assortments	171.28.654S01	1			015	020	025	030	035	040						
			171.28.654S02	1								045	050	055	060	070	080	
654	L=31	340 654 642 451 ...	171.31.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
		Assortments	171.31.654S01	1			015	020	025	030	035	040						
			171.31.654S02	1								045	050	055	060	070	080	

Manuelle Aufbereitung: Anwendung mit Druckbewegung bei max. 90° und Drehbewegung im Uhrzeigersinn.
 Manual preparation: application with pressure movement 90° max. and clock-wise rotary movement.
 Préparation manuelle: application avec pression et un mouvement de rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

173   
 Wurzelkanalfeile Typ „K“
 „K“ - Files
 Lime „K“

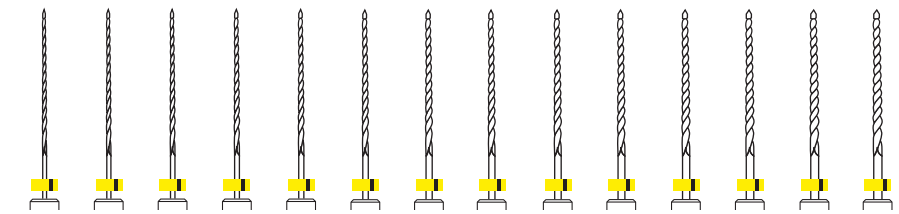

Shank	ISO	Order No.	ISO	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	
654	L=21	340 654 645 452 ...	173.21.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
		Assortments	173.21.654S01	1			015	020	025	030	035	040						
			173.21.654S02	1								045	050	055	060	070	080	
654	L=25	340 654 646 452 ...	173.25.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
		Assortments	173.25.654S01	1			015	020	025	030	035	040						
			173.25.654S02	1								045	050	055	060	070	080	
654	L=28	340 654 647 452 ...	173.28.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
		Assortments	173.28.654S01	1			015	020	025	030	035	040						
			173.28.654S02	1								045	050	055	060	070	080	
654	L=31	340 654 648 452 ...	173.31.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
		Assortments	173.31.654S01	1			015	020	025	030	035	040						
			173.31.654S02	1								045	050	055	060	070	080	

Manuelle Aufbereitung: Feilende Bewegungen verbunden mit Drehbewegungen mit max. 45° im Uhrzeigersinn.
 Manual preparation: filing motion combined with rotary movements clock-wise 45° max.
 Préparation manuelle: mouvement de limage combiné avec une rotation de 45° maximum dans le sens des aiguilles d'une montre.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban